




普通级动物实验室接收率温湿度221

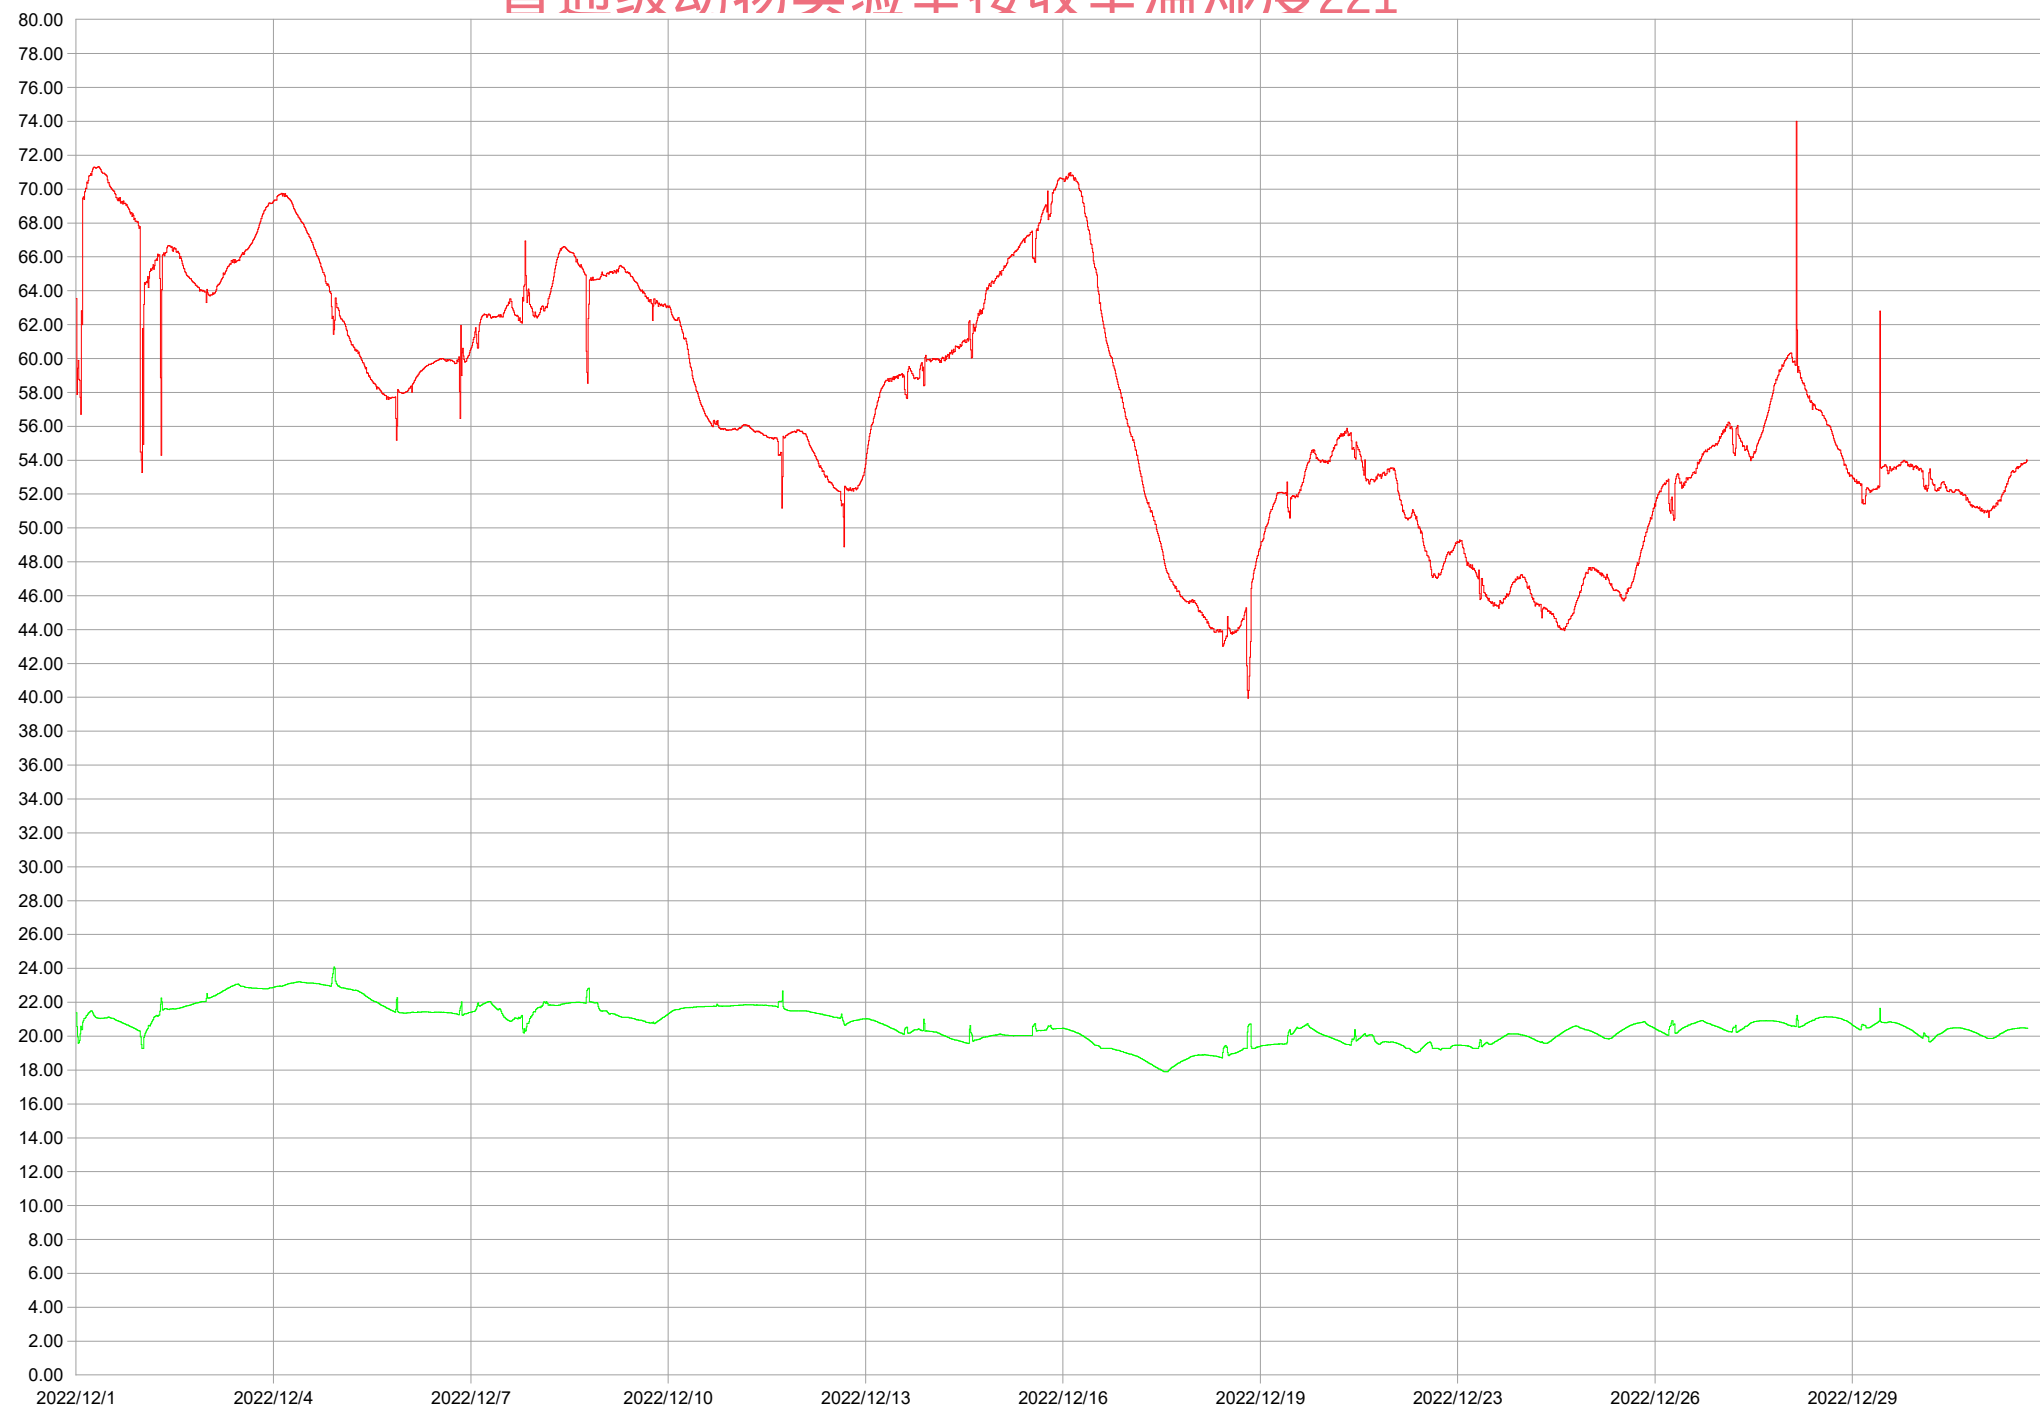

普通级动物实验室检疫室温湿度221

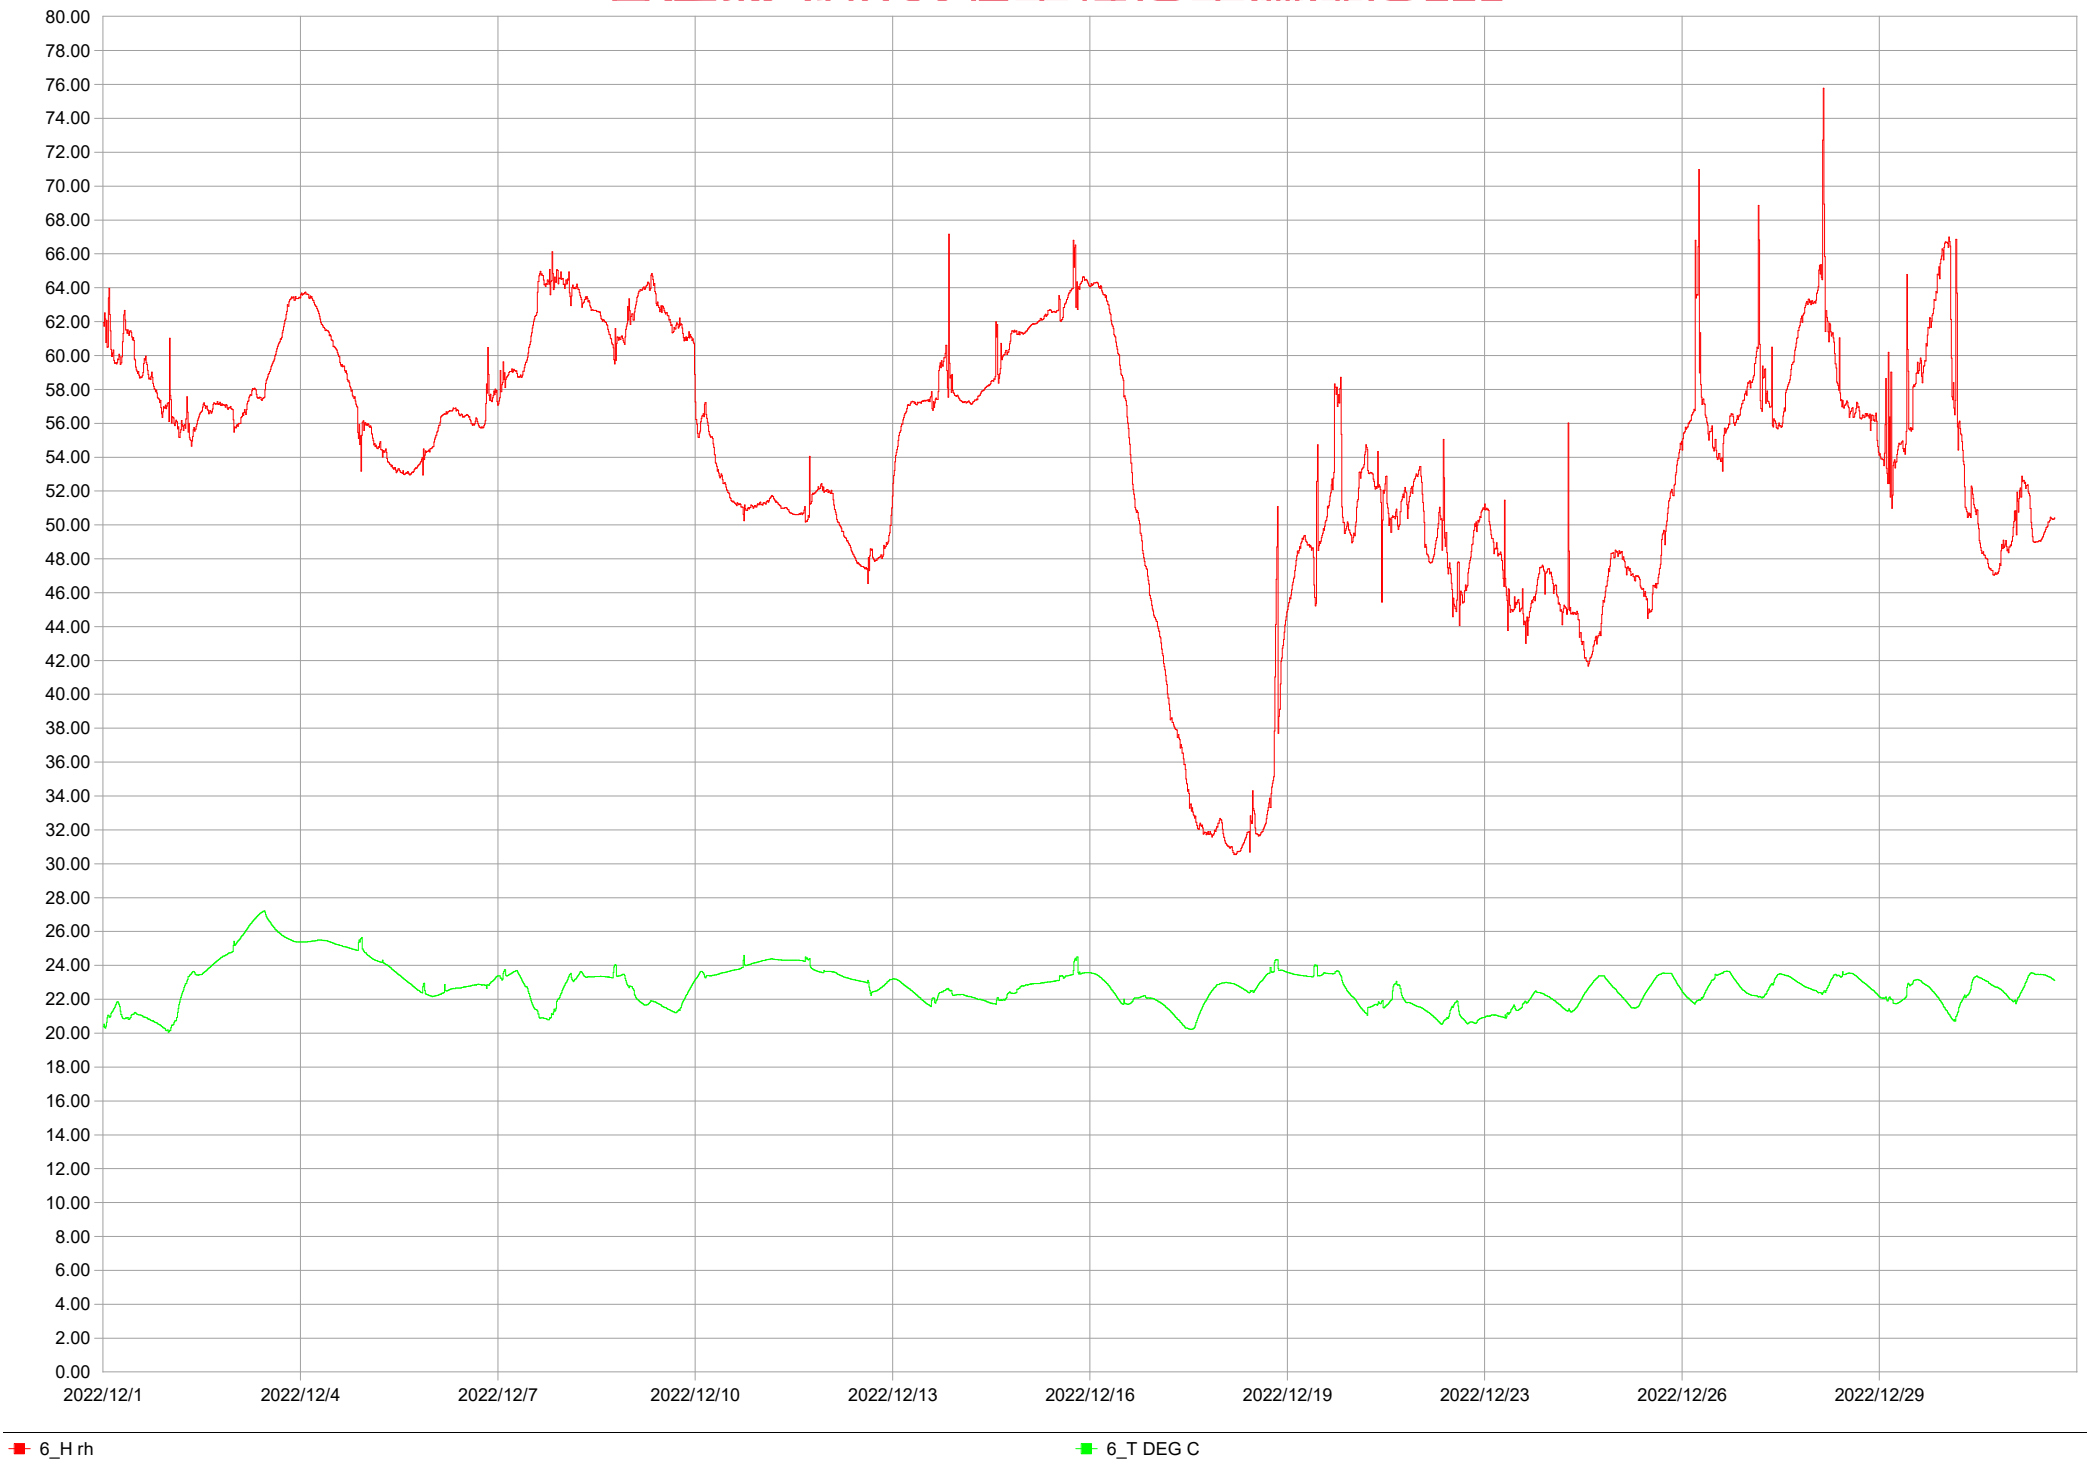

普通级动物实验宰兔饲养室温湿度221

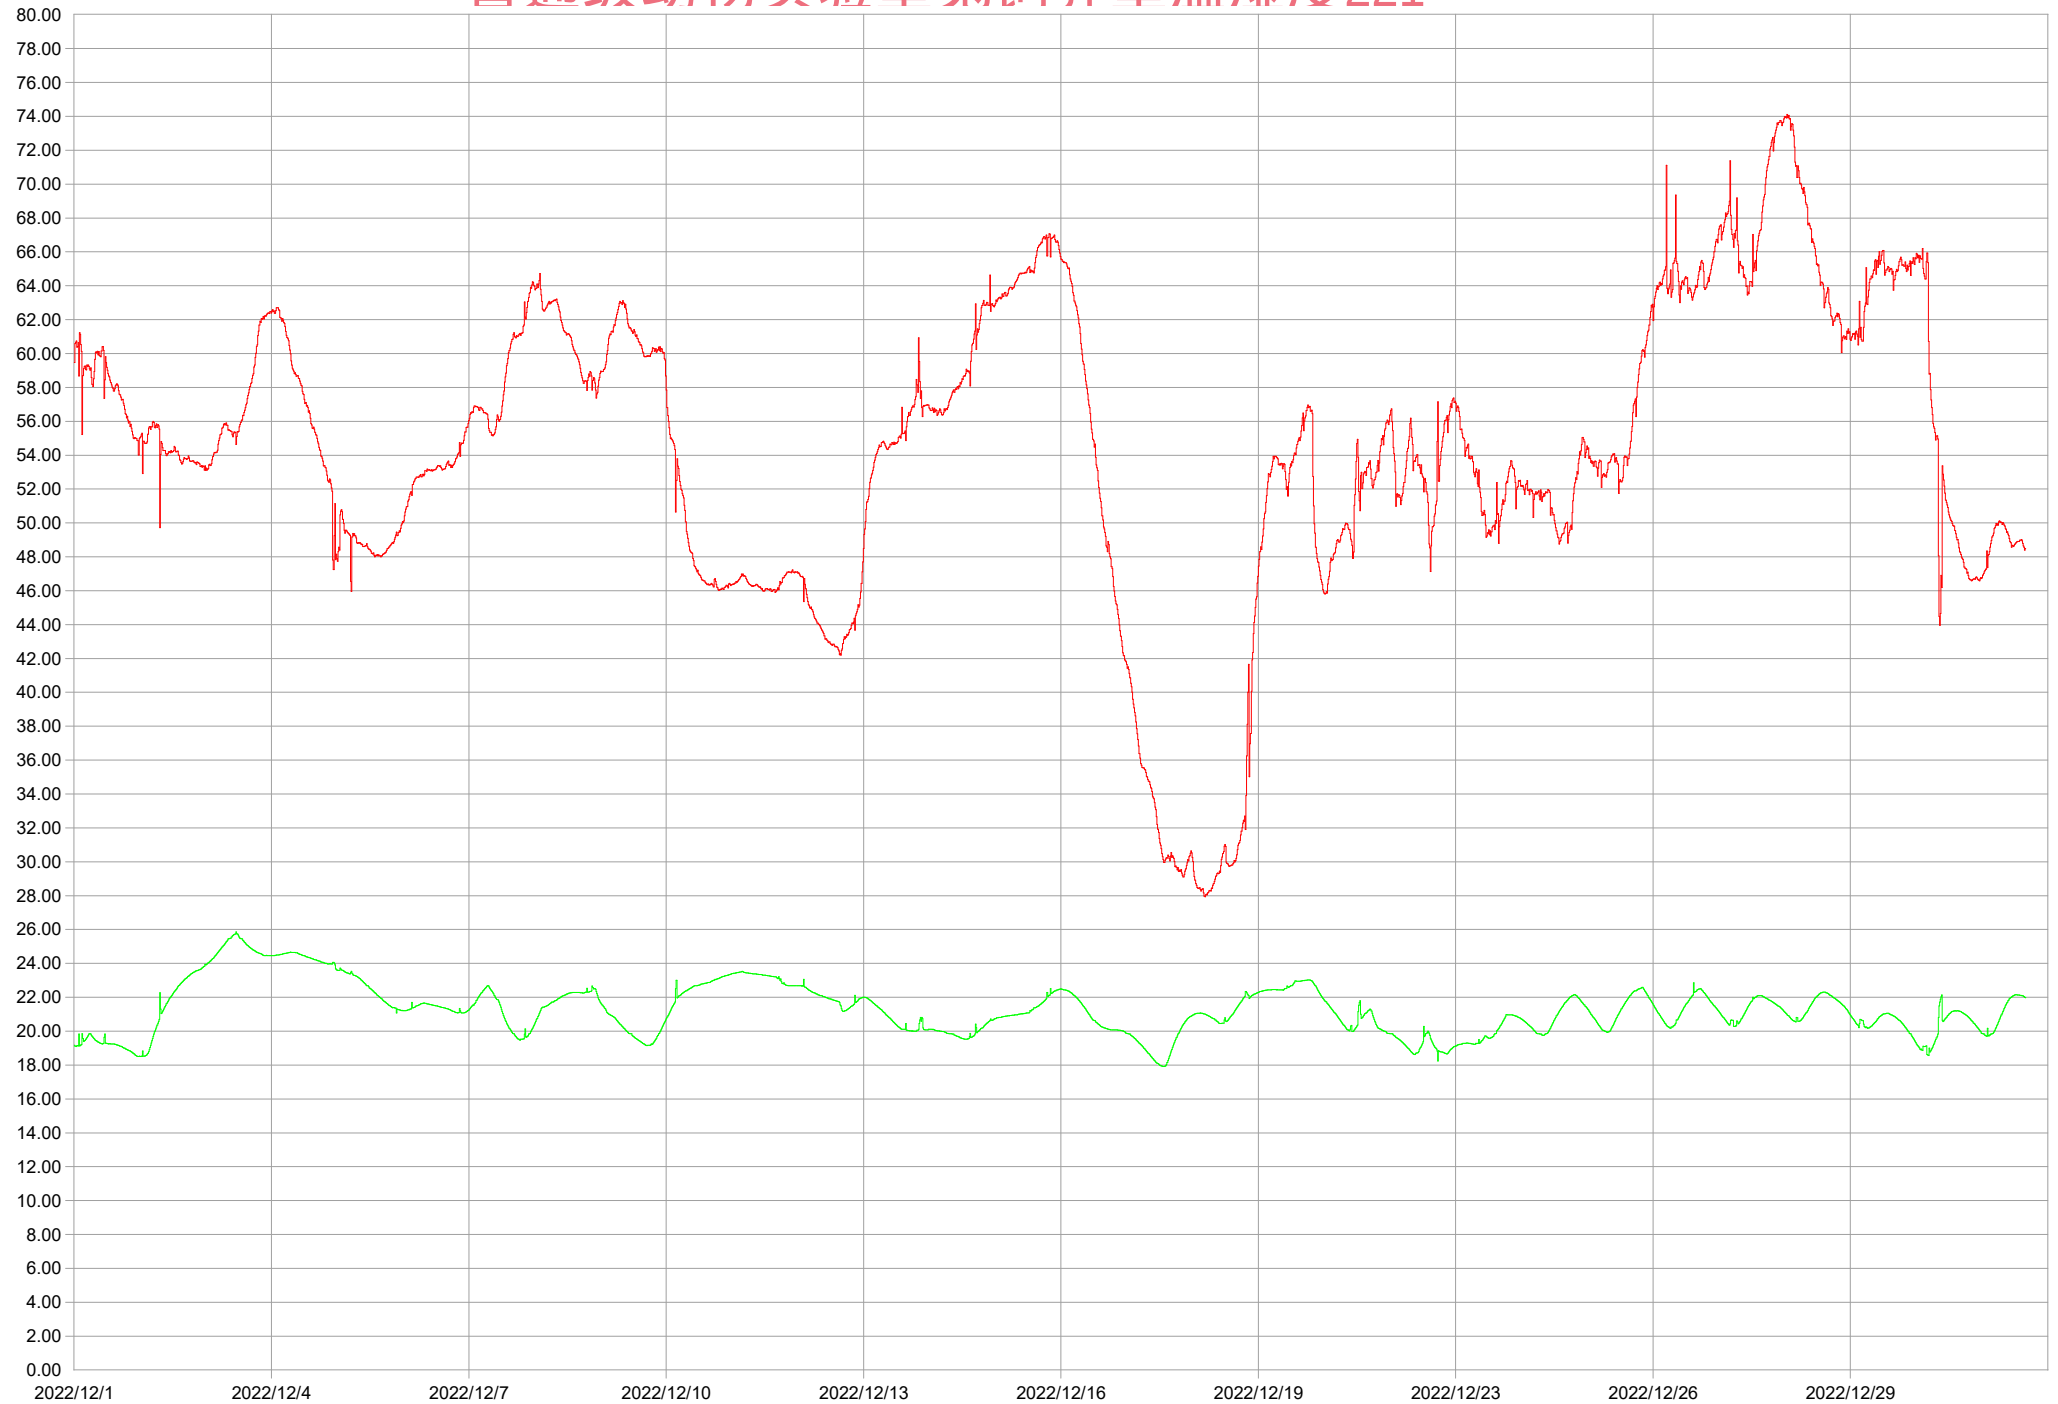

普通级动物实验室豚鼠饲养室温湿度221

